



Basic Operation

STT	Diễn Tả/ Description
1	Ổ đặt Detector - Detector bay
2	Vít vặn- Access Hatch Screw x 2
3	Đồng hồ áp suất khí- Pressure Gauge
4	Chai khí- Gas bottle
5	Thẻ USB- USB Memory Stick
6	Đèn (Detector)- Unit Led (x4)
7	Đèn báo năng lượng- Power Led
8	Nút nhấn - Buttons
9	Cổng sạc điện- Charging port
10	Cổng thoát khí- Exhaust port
11	Bộ điều hòa-Solenoid,Regulator,Gauge
12	Cổng nối khí ngoài (Optional)-Gas inlet

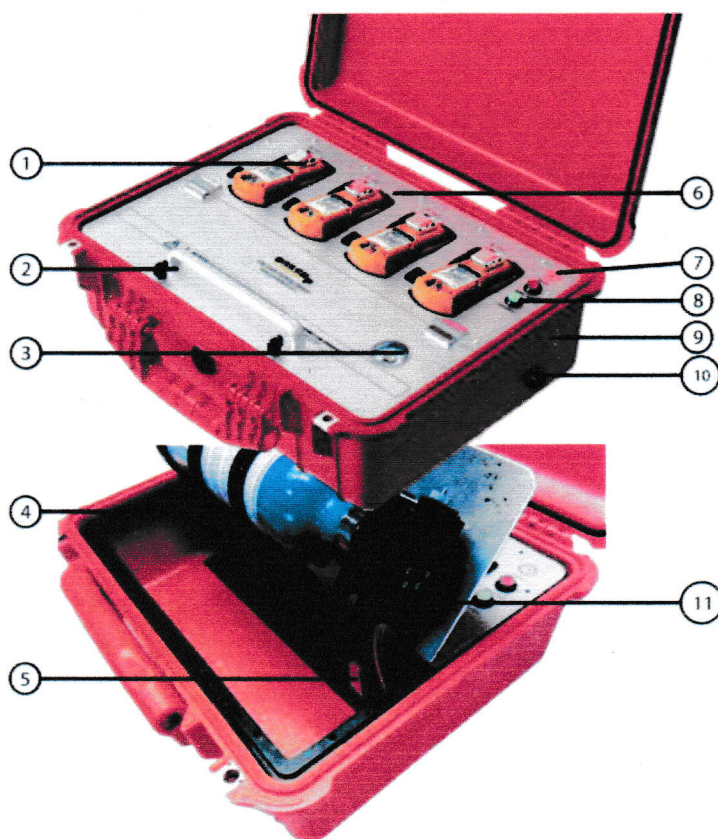

- Model : MGC DOCK

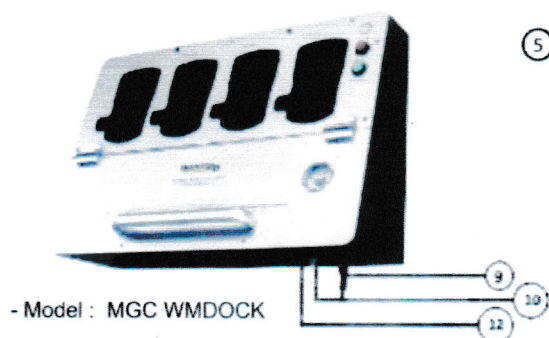

- Model : MGC WMDOCK

LEDs

Đèn Unit LED	ORANGE - màu cam	Đang hoạt động
	RED- màu đỏ	Thất bại
	GREEN- màu xanh	ĐẠT
	ORANGE cycling- màu cam chạy vòng	Đang sạc điện
Đèn Power LED	GREEN- màu xanh	Đang mở máy
	GREEN blinking- màu xanh chớp tắt	Pin yếu
	ORANGE -màu cam	Đang hoạt động
	ORANGE blinking - màu cam nhấp nháy	Không gắn USB

Thiết bị (Clip Dock) không ghi nhận dữ liệu nếu thẻ USB không gắn vào

The Clip Dock will be unable to record test results if USB memory is not installed

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Model : MGC- DOCK

Model : MGC- WMDOCK

Thiết bị MGC-DOCK, MGC-WMDOCK : Dùng để cân chỉnh và bump test cho máy dò khí (Gas Detector) của **GASCLIP TECHNOLOGIES** với các model : MGC- IR , MGC-P ,MGC- 2 ,MGC-2-P

* **TẮT- MỞ MÁY**

- **MỞ** : Nhấn một trong hai nút
- **TẮT** : Thiết bị tự động tắt sau khi hoàn tất hoạt động

* **SẠC ĐIỆN**

- **THỜI GIAN SẠC** : Khoảng 3 giờ - Trong khi sạc đèn báo Unit LED sáng chạy vòng theo thứ tự - **THỜI GIAN SỬ DỤNG/1 LẦN SẠC** : Khoảng 1.500 lần Bump Test
- **KHÔNG** sạc điện ở môi trường dưới 0⁰c và trên 40⁰ c
- **KHÔNG** dùng các loại sạc điện khác không phải của Gasclip Technologies

* **LẮP ĐẶT CHAI KHÍ CÂN CHỈNH**

- Mở 2 ốc vít ở khoang chứa chai khí , Gắn vào bộ điều hòa khí CG-10 theo chiều kim đồng hồ
- Khi ráp đúng đồng hồ áp suất chai khí sẽ báo hiệu số lượng khí còn lại trong chai
- **Nồng Độ Khí Cân Chỉnh** mặc định là : H2S : 25 ppm ; CO : 100 ppm ; O2 : 18 % ; LEL : 50%
- Có thể thay đổi **Nồng Độ Khí Cân Chỉnh** bởi phần mềm GCT MANAGER (Download từ www.gascliptech.com)

* **NÚT SỬ DỤNG**

- **BUMP TEST** : nhấn nút bump test - Thời gian bump test : khoảng 20 giây
- Đèn VÀNG : đang chạy - Đèn XANH : Đạt - Đèn ĐỎ :Thất bại
- **Khi hoàn tất Detector sẽ báo động và đèn Unit Led tắt**
- **CÂN CHỈNH** : nhấn nút Calibration- Thời gian cân chỉnh : khoảng 90 giây
- Đèn VÀNG : đang chạy - Đèn XANH : Đạt - Đèn ĐỎ :Thất bại
- **Khi hoàn tất Detector sẽ báo động và đèn Unit Led tắt**
- Một lần **Bump Test** hoặc **Cân chỉnh** được từ 1 đến 4 máy
- **NHẤN 2 NÚT CÙNG LÚC** : Tắt detector

* **NHỮNG NGUYÊN NHÂN LÀM VIỆC CÂN CHỈNH& BUMP TEST KHÔNG THÀNH CÔNG**

- Cảm biến/Sensor bị hư ; Có những vật cản ở cổng loa âm thanh hoặc trên máy
- Đầu cảm biến hồng ngoại trên sensor bị dơ (Nên làm sạch bằng vải sạch mềm)
- Chai khí đã hết khí (Chai khí 58 L khi đầy đồng hồ áp suất chỉ 500 PSI - Chai 116 L chỉ 1.000 PSI)
- Ánh sáng chói làm ảnh hưởng đến tia sáng hồng ngoại đang làm việc giữa Detector và thiết bị (clip dock) - **NÊN** di chuyển đến chỗ ánh sáng ít chói hơn
- Nếu sau 3 lần vẫn thất bại - liên hệ Gasclip Technologies

GAS CLIP TECHNOLOGIES

610 Uptown Blvd,Suite 4100

Cedar Hill TX 75 104

Toll Free : (877) 525 0808

Phone : (972) 775-7577 - Fax : (972) 775 2483

Email : info@gascliptech.com - Website : www.gascliptech.com

Hoặc liên hệ Trung Tâm Bảo Hành-Sửa chữa VN : KIM CONG Co ;LTD - Hotline : 0903833667